

# ミクニバスキャリー 取扱説明書

このたびはミクニバスキャリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
このミクニバスキャリーは身体の不自由な方がリフトで入浴する際、介助の方の労力を軽減する目的で作られております。  
本説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さいますよう、お願い申し上げます。

お問合せは

販売店

製造元

株式会社 **ミクニライフ&オート**

〒349-1145

本社 埼玉県加須市間口456-1

TEL:0480-31-8541


# 1. 安全上の注意

ご使用の前に、この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いになって下さい。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止する為のものです。その表示と意味は次のようになっております。

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損傷のみの発生が想定される内容を示します。
<b>警告</b>	吊りベルトをリフトのハンガーに正しくかけて下さい。 重大な事故につながる恐れがあります。
<b>警告</b>	安全ベルトを必ず締めてお使い下さい。 重大な事故につながる恐れがあります。
<b>警告</b>	吊りベルト、安全ベルト、シート地がいたんできた場合は使用を止めて下さい。 重大な事故につながる恐れがあります。
<b>警告</b>	キャリーを使用する際は、必ず介助者が付き添って使用して下さい。 重大な事故につながる恐れがあります。
<b>警告</b>	吊りベルトの接続金具が確実に接続されていることを確認して下さい。 重大な事故につながる恐れがあります。
<b>警告</b>	段差の乗り越えなどで前輪を浮かせる場合、80mm以上浮かさないで下さい。 転倒してケガをする恐れがあります。
<b>警告</b>	キャリーへの乗り降りや浴室での使用時は、動かないように前輪をロックして下さい。 不意に動き出すと、転倒したり壁や器物にぶつかりケガをする恐れがあります。
<b>警告</b>	お子様のいたずらに注意して下さい。 転倒してケガをする恐れがあります。
<b>警告</b>	リフトで吊り上げるとき以外は必ずスプリングキャッチで、チェア部、キャリー一部を固定して下さい。 転倒してケガをする恐れがあります。
<b>注意</b>	お手入れの際、酸性・アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、たわしを使用したり、熱湯をかけたりしないで下さい。 本体をいためたり、変形する恐れがあります。
<b>注意</b>	商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 2. 各部の名称

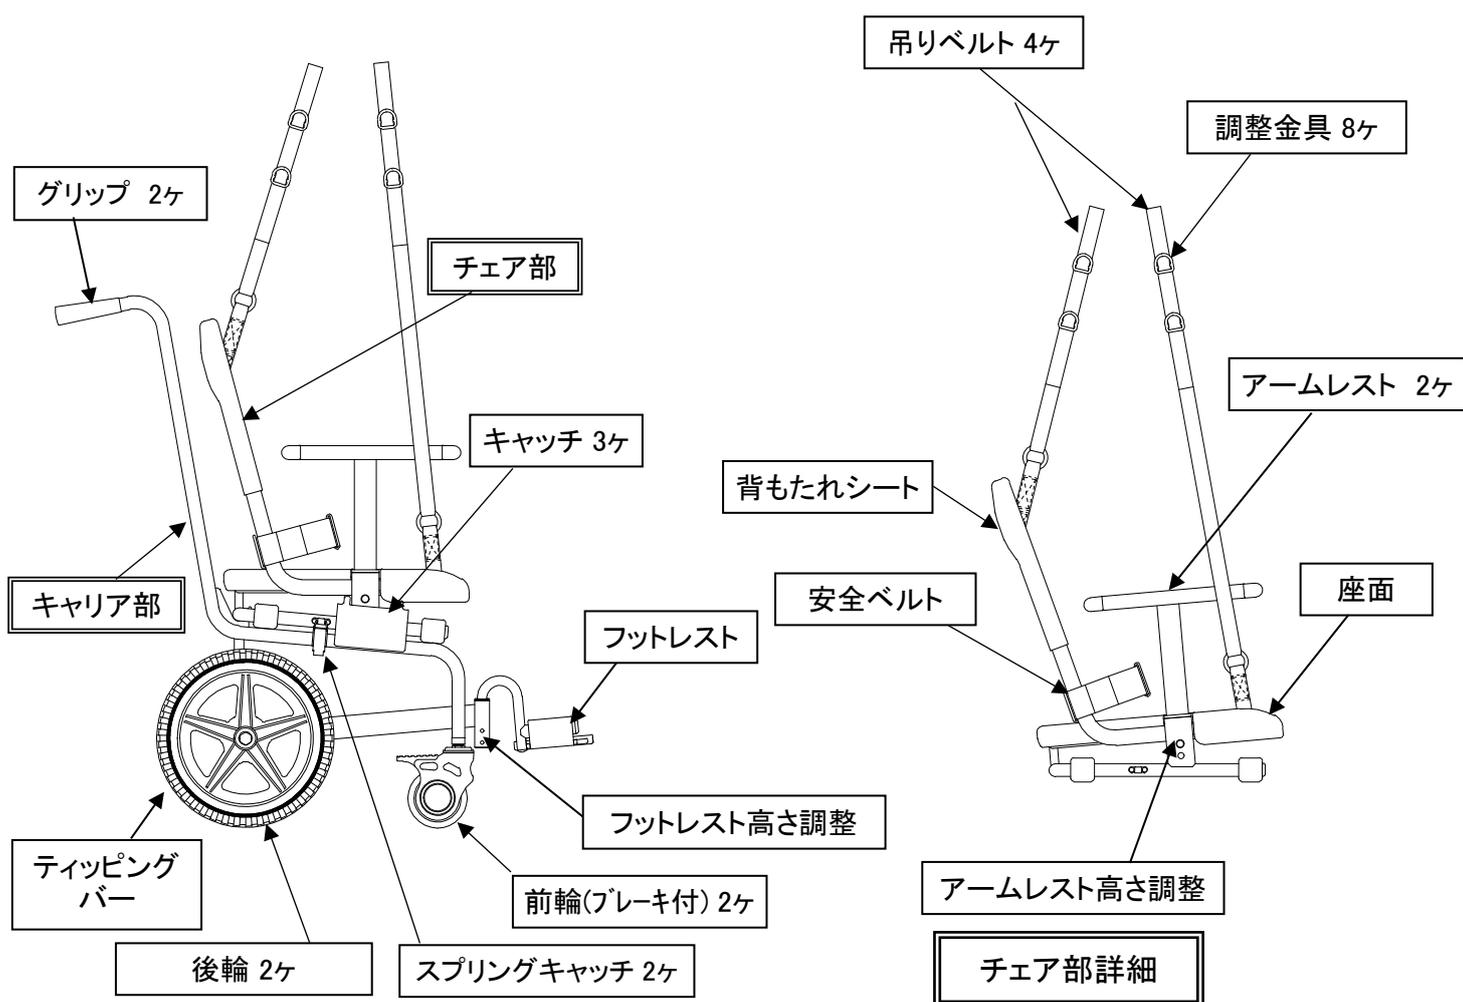

## 3. 使用方法

寝室や居室から本人をミニバスキャリアに移乗させ、直接浴室に移動し、リフトで吊り上げることで座ったまま脱衣場・洗い場・浴槽への移動ができます。

### (1) はじめに

①アームレスト、フットレストの高さの調整を行います。

アームレスト高さ調整幅 20mmで2段階

フットレスト高さ調整幅 20mmで2段階

調整方法 : ドライバーを使用し、ピンを外し、適切な高さで固定して下さい。

②吊りベルトの長さ調整を行います。

人を乗せない状態で、リフトにチェア部を吊り下げ、浴槽の底からキャリアに載せるまで、どこにもぶつからないことをリフトを上下させながら確認し、一番高いところ、一番低いところで問題のない吊りベルトの長さを決め、調整金具で長さを調節して下さい。尚、4ヶ所それぞれの吊りベルトがバランスが取れているか確認して下さい。

### (2) ミニバスキャリアへの移乗

本人をベッドの端に移動させ、キャリアをベッドに対して30°程度の角度で健康な足の側に置き、ブレーキをかけ、フットレストは跳ね上げておきます。ベッドから車椅子へ移乗させるのと同様に本人を移乗させます。

その後、フットレストを元に戻しブレーキを解除して下さい。

その際、キャリア部とチェア部左右のスプリングキャッチが確実に固定されていることを確認して下さい。

### (3) 室内での移動

車いすを移動させるのと同様に移動します。尚、移動する際に、足はフットレストの上に置き、両手は左右のアームレストを利用すると、より安定して移動できます。

その際、キャリア部とチェア部左右のスプリングキャッチが確実に固定されていることを確認して下さい。

### (4) 浴室での使用

チェア部に座ったままリフトで吊り上げ浴槽に入ることができます。

吊りベルトをリフトのハンガーに接続し左右のスプリングキャッチを外します。この状態で、リフトを操作してチェア部を吊り上げます。その際、キャスターのブレーキはかけておいた方がより安定します。

(リフトの取扱説明に従って下さい)入浴終了後はキャリア部と合体後チェア部左右のスプリングキャッチを確実に固定します。居室に戻る際はキャリアに水滴が付着していますので、タオル等で拭き取ることをお勧めします。また、熱湯をかけることはお止め下さい。

### (5) 段差を超える場合

段差を超える場合は、車いすと同様に介護者が片足でティッピングバーを踏みキャリアの前方を上げて下さい。

上げる際、80mm以上前を持ち上げないで下さい。

## 4. お手入れのしかた

通常は柔らかい布で水拭きをして下さい。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して拭き、そのあと水で二度拭きして下さい。

消毒をする場合は、アルコールか薄めた逆性石鹼を使用して下さい。

背もたれシートは着脱式ですので取り外して手洗いもしくは、洗濯機でネットに入れて洗うことができます。

アームレスト、フットレストは取り外して洗うことができます。

酸性・アルカリ性、ベンジン、シンナー、クレンザー、たわしなどは本体を傷つけるので使用しないで下さい。

熱湯は本体を変形させることがありますので使用しないで下さい。

濡れた状態で放置するとカビが発生する恐れがありますので、水分を拭き取っておいて下さい。

## 5. オプション


オプションで姿勢保持のための前方グリップをご利用できます。

前方グリップを使用する際には、前方グリップに付属する取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。


## 6. センターブレーキの使用法(施設用および特別注文品)

この装備は、キャリアの後輪を一つのペダルで左右輪同時にロック、解除できるものです。

### ・ロック方法

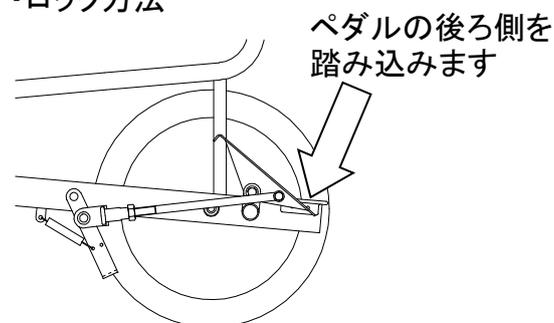

### ・解除方法

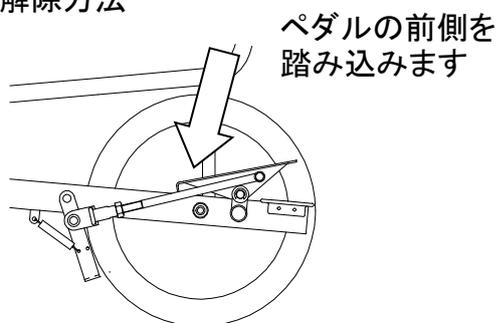

※ ペダル部分はステンレス製です。操作時に足がすべらないように注意して下さい。

MEMO